



People.Health.Care.

Kurzbedienungsanleitung der Therapieeinheit




endo

1. Suprasorb® CNP endo Therapieeinheit



- A Einweg-Exsudatbehälter mit integriertem Exsudatbehälterschlauch
- B Verriegelung für Behälter
- C Tasten  (Ein) und  (Aus)
- D Display
- E Plus-  und Minustaste 
- F **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit
- G Anschluss für Netzgerät

Anschluss des Einweg-Exsudatbehälters an die Suprasorb® CNP endo Therapieeinheit




- A Einweg-Exsudatbehälter inkl. Exsudatbehälterschlauch
- B Verriegelung für Behälter
- C Sauganschluss
- D **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit
- E Führungsschiene

1. Nehmen Sie den Einweg-Exsudatbehälter (A) aus der Verpackung.
2. Schieben Sie den Behälter auf die Führungsschiene (E) an der **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit, bis der Einweg-Exsudatbehälter hörbar an der Verriegelung (B) einrastet.


Verbinden Sie den Schlauch des Einweg-Exsudatbehälters mit der Drainage.

2. Behälterwechsel

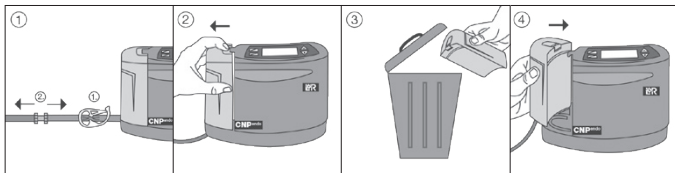

1. Drainageschlauch abklemmen
2. Exsudatbehälterschlauch abklemmen (Abb. 1-1).
3. Therapie pausieren, oder Gerät ausschalten
4. Exsudatbehälterschlauch vom Drainageschlauch lösen (Abb. 1-2)
5. Einweg-Exsudatbehälter-Verriegelung drücken und abziehen.
6. Entsorgen Sie den Einweg-Exsudatbehälter ordnungsgemäß (Abb. 3).
7. Fixieren Sie einen neuen Einweg-Exsudatbehälter an der Therapieeinheit (Abb. 4).
8. Verbinden Sie den Exsudatbehälterschlauch mit dem Drainageschlauch.
9. Lösen Sie die Klemmen am Drainageschlauch.
10. Therapie starten (siehe nächste Seite).

3. Inbetriebnahme



Suprasorb® CNP endo
Therapieeinheit mit
angeschlossenem Behälter horizontal

Der Druckwert des Unterdrucks kann von -40 mmHg bis -125 mmHg in 5 mmHg-Schritten eingestellt werden. Voreingestellt sind -125 mmHg.



1. Drücken Sie 1-2 Sekunden lang die Taste , um die **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit einzuschalten. Der folgende Start-Screen erscheint für 5 Sekunden.



2. Es erscheint der Übersichtsbildschirm.



3. Mit der Plus- und Minustaste   können Sie den verordneten Unterdruck einstellen und mit der Taste  können Sie die Therapie beginnen. Es erscheint der Therapiebildschirm. (Voreinstellung des Sollwerts: -125 mmHg)



4. Drücken Sie die Taste , um die Therapie zu stoppen.



5. Schalten Sie die **Suprasorb CNP endo** Therapieeinheit aus, indem Sie 3 Sekunden lang die Taste  drücken.

Tastensperre lösen

Zum Deaktivieren drücken Sie   gleichzeitig.

Die Therapieeinheit darf nicht auf dem Kopf stehend betrieben werden.

Laufzeit im Akkubetrieb ca. 24-48 Stunden
Ladezeit bei leerem Akku 6-7 Stunden


4. Fehlerbehebung



Netzgerät anschließen.



Netzgerät kurz einstecken und wieder entfernen. Tritt der Fehler 60 Sekunden nach dem Neustart wieder auf, wenden Sie sich an L&R.




Netzgerät bald anschließen.



Therapie starten.

Therapie ausschalten.



Korrekte Anschlüsse prüfen.
Lage der Drainage prüfen.
Therapie starten.



Schlauchanschlüsse und Einweg-Exsudatbehälter überprüfen. Therapieeinheit ausschalten oder pausieren. Wundbereich optisch/endskopisch kontrollieren. Ggf. CO₂-Insufflation beenden. Therapieeinheit wieder einschalten bzw. Therapie starten.



Therapieeinheit ausschalten oder pausieren. Einweg-Exsudatbehälter prüfen und gegebenenfalls wechseln. Schläuche prüfen. Schlauchklemme öffnen.

Kontaktieren Sie L&R, wenn ein aufgetretener Fehler nicht mit den hier beschriebenen Maßnahmen behoben werden kann.

5. Weiterführende Informationen

Nähere Informationen zur CNP endo Therapieeinheit finden Sie in der Gebrauchsanweisung.


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre L&R Ansprechpartner:innen.

6. Kontaktdaten

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
D-56579 Rengsdorf

CNP Service-Hotline:
0800 6647435

**L&R CNP Team –
Ihre Ansprechpartner:innen**



www.lohmann-rauscher.com

9510366 0924 de